Shoe Holder Straps-Webbing Style

36350	30107S
36351	30107M
36352	30107L
36353	30107X

en To support proper foot positioning

fr Pour soutenir le positionnement correct du pied

de Zur Unterstützung der richtigen Fußpositionierung

it Per supportare il corretto posizionamento del piede

pt Para apoiar o posicionamento correto do pé

es Para apoyar el posicionamiento adecuado del pie

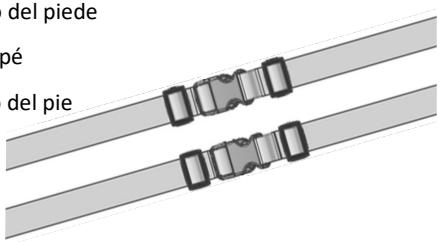

This product is for positioning only. It should not be relied on for occupant restraint in a moving vehicle.
Ce produit est uniquement pour le positionnement. Il ne doit pas être utilisé pour la retenue des occupants dans un véhicule en mouvement.
Dieses Produkt dient nur der Positionierung. Es sollte nicht als Rückhaltesystem für Insassen in einem fahrenden Fahrzeug verwendet werden.
Questo prodotto è solo per il posizionamento. Non deve essere utilizzato per il trattenimento degli occupanti in un veicolo in movimento.
Este produto é apenas para posicionamento. Não deve ser usado para retenção de ocupantes em um veículo em movimento.
Este producto es solo para posicionamiento. No debe confiarse en él para la retención de ocupantes en un vehículo en movimiento.

Do not continue to use the device after identifying loose or broken components. Failure to comply may result in injury to the user.
Ne continuez pas à utiliser l'appareil après avoir identifié des composants desserrés ou cassés. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures pour l'utilisateur.
Setzen Sie die Verwendung des Geräts nicht fort, nachdem Sie lockere oder gebrochene Komponenten festgestellt haben. Die Nichteinhaltung kann zu Verletzungen des Benutzers führen.
Non continuare a utilizzare il dispositivo dopo aver identificato componenti allentati o rotti. Il mancato rispetto può causare infortuni all'utente.
Não continue a usar o dispositivo após identificar componentes soltos ou quebrados. O não cumprimento pode resultar em lesão ao usuário.
No continúe usando el dispositivo después de identificar componentes sueltos o rotos. El incumplimiento puede resultar en lesiones al usuario.

Read owners manual before use
Lire le manuel du propriétaire avant utilisation
Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der Verwendung
Leggere il manuale del proprietario prima dell'uso
Leia o manual do proprietário antes de usar
Lea el manual del propietario antes de usar

Do not make changes to the positioning device unless you have consulted your authorized supplier first. Failure to comply may result in injury to the user.
Ne modifiez pas le dispositif de positionnement sans avoir consulté au préalable votre fournisseur autorisé. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures pour l'utilisateur.
Ändern Sie das Positionierungsgerät nicht, ohne zuvor Ihren autorisierten Lieferanten zu konsultieren. Eine Nichteinhaltung kann zu Verletzungen des Benutzers führen.
Non apportare modifiche al dispositivo di posizionamento senza aver prima consultato il tuo fornitore autorizzato. Il mancato rispetto può causare infortuni all'utente.
Não faça alterações no dispositivo de posicionamento sem antes consultar seu fornecedor autorizado. O não cumprimento pode resultar em lesão ao usuário.
No realice cambios en el dispositivo de posicionamiento a menos que haya consultado primero a su proveedor autorizado. El incumplimiento puede resultar en lesiones al usuario.

Document 08574
Revision C 4-2025

MD CE

1

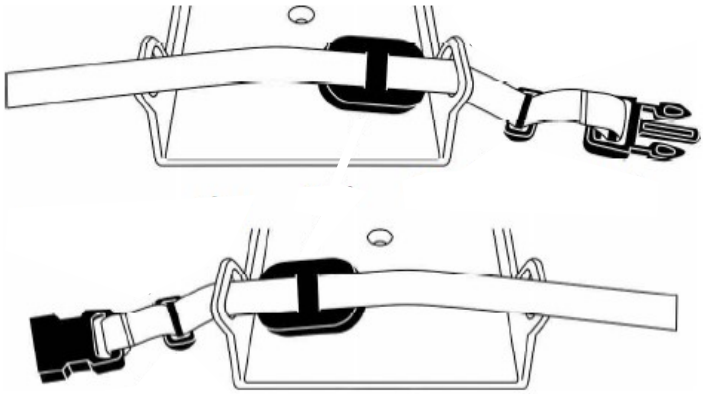

2

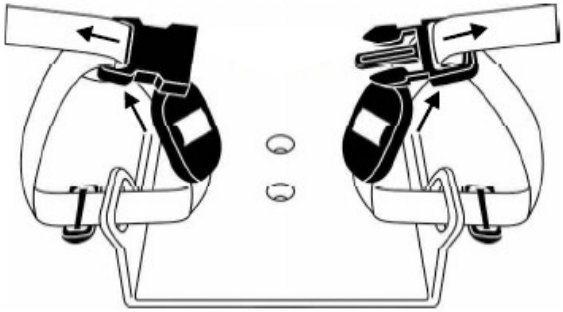

3

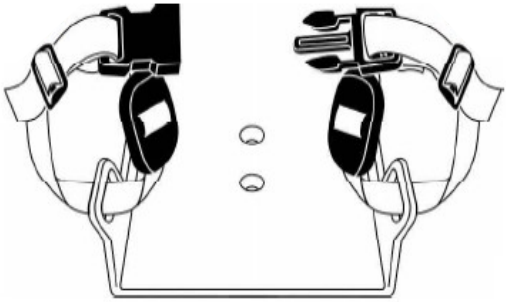

If patient experiences any skin irritation or severe discomfort contact your healthcare professional or medical technician. If any serious incident or injury occurs please contact Therafin Corp. and the competent authority for your country. Product is made of materials which can be disposed of safely without special precautions.

Si le patient ressent une irritation cutanée ou un inconfort sévère, contactez votre professionnel de santé ou technicien médical. Si un incident grave ou une blessure survient, veuillez contacter Therafin Corp. et l'autorité compétente de votre pays. Le produit est fabriqué à partir de matériaux qui peuvent être éliminés en toute sécurité sans précautions particulières.

Wenn der Patient Hautreizungen oder starke Unannehmlichkeiten verspürt, kontaktieren Sie Ihren Gesundheitsdienstleister oder medizinischen Techniker. Bei einem schwerwiegenden Vorfall oder Verletzung kontaktieren Sie bitte Therafin Corp. und die zuständige Behörde Ihres Landes. Das Produkt besteht aus Materialien, die ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen sicher entsorgt werden können.

Se il paziente sperimenta irritazioni cutanee o disagio grave, contattare il proprio professionista sanitario o tecnico medico. In caso di incidenti gravi o infortuni, si prega di contattare Therafin Corp. e l'autorità competente per il proprio paese. Il prodotto è fatto di materiali che possono essere smaltiti in sicurezza senza precauzioni speciali.

Se o paciente apresentar irritação na pele ou desconforto severo, contate seu profissional de saúde ou técnico médico. Se ocorrer algum incidente grave ou lesão, por favor, contate a Therafin Corp. e a autoridade competente do seu país. O produto é feito de materiais que podem ser descartados de forma segura sem precauções especiais.

Si el paciente experimenta cualquier irritación de la piel o molestias severas, contacte a su profesional de la salud o técnico médico. Si ocurre algún incidente serio o lesión, por favor contacte a Therafin Corp. y a la autoridad competente de su país. El producto está hecho de materiales que se pueden desechar de manera segura sin precauciones especiales.

Any product found to be defective due to the material or workmanship within one year will be replaced under our return policy following product evaluation by Therafin Corp.. This replacement warranty does not include misuse or neglect of the product.

Tout produit reconnu défectueux en raison du matériel ou de la fabrication dans l'année sera remplacé selon notre politique de retour suite à une évaluation du produit par Therafin Corp.. Cette garantie de remplacement n'inclut pas la mauvaise utilisation ou la négligence du produit.

Jedes Produkt, das innerhalb eines Jahres aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern als defekt befunden wird, wird gemäß unserer Rückgaberichtlinie nach einer Produktbewertung durch Therafin Corp. ersetzt. Diese Ersatzgarantie schließt Missbrauch oder Vernachlässigung des Produkts nicht ein.

Qualsiasi prodotto riscontrato difettoso a causa del materiale o della manodopera entro un anno sarà sostituito secondo la nostra politica di reso a seguito della valutazione del prodotto da parte di Therafin Corp.. Questa garanzia di sostituzione non include l'uso improprio o la trascuratezza del prodotto.

Qualquer produto que se revele defeituoso devido ao material ou fabricação dentro de um ano será substituído conforme nossa política de devolução, após avaliação do produto pela Therafin Corp.. Esta garantia de substituição não inclui mau uso ou negligência do produto.

Cualquier producto que se encuentre defectuoso debido al material o la mano de obra dentro de un año será reemplazado bajo nuestra política de devolución tras una evaluación del producto por Therafin Corp.. Esta garantía de reemplazo no incluye el mal uso o negligencia del producto.

Document 08574
Revision C 4-2025

MD CE

EC REP

MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

Therafin

AltimateMedical
creating products · changing lives

Altimate Medical Inc.
9450 W Laraway Road
Frankfort, IL 60423 USA
800-843-7234